

重要なお知らせ

最新版

ストラクチャスキャン SIR-EZ XT ver 1.5.4 最新バージョンについて 精度と機能が改善されました




いつもストラクチャスキャン SIR-EZ XTをご利用いただき誠に有難うございます。この度、ストラクチャスキャン SIR-EZ XTの最新版ver1.5.4がリリースされました為、ご案内申し上げます。

最新版ver.1.5.4は、無償でバージョンアップが可能ですので、是非この機会に最新版へ移行をお願い申し上げます。

●改善内容

- ✔「浅い深度の精度UP」：浅い箇所の自動深度機能がさらに精度が高くなりました
- ✔「簡単手動ゲイン機能追加」：表層部・深層部の波形だけをゲイン調整可能になりました

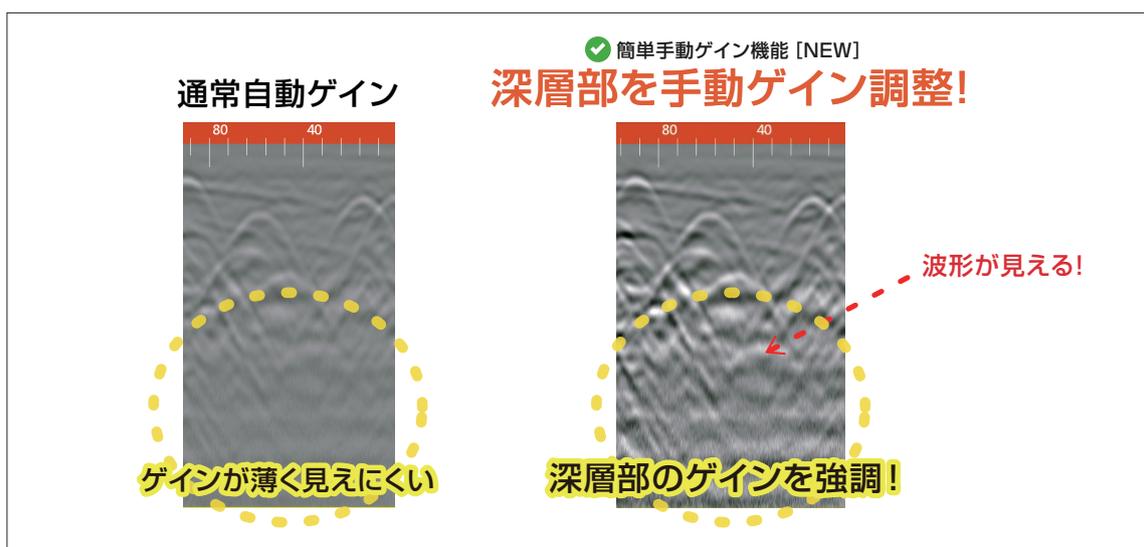

●無償バージョンアップ方法

- ・点検校正時に併せて実施 ※点検校正を依頼後、弊社へ機器をお送りください
- ・展示会会場、弊社主催のトレーニング会場にて実施 ※お客様自身で機器を持ち込みください

●Report Editor Pro (報告書作成ソフト) をお持ちの方 [重要]

バージョンを ver1.8.3 以上にしてください

ver.1.8.2以下をお使いの方は、XTを最新版にした場合、波形に誤差が出てしまう場合がございます。無償でバージョンアップ可能ですので、必ずバージョンアップをお願いいたします。

現在お使いのバージョンが、ver.1.6.2.x以上の場合、上のメニュー内にある[ヘルプ]内[アップデートの確認]より最新版をダウンロード可能です。ver.1.6.2.x以下の場合、弊社担当までお問合せください。